Mikrometerskrue kontrolkort		Navn
Skive Tekniske Skole	**Kalibrering**	Mikrometerskrue ID. Nr. Kontrol Dato:
Stamdata for mikrometerskrue		
Levarandør:	Fabrikat:	Anskaffelsespris:
Kalibreringsinterval:	Certifikat nr:	Dato.

Tolerancer for mikrometerskrue			
Målelængde i mm	Tilladt afvigelse på visning i µm	Kontrol mål: 0 – 2,7 – 5,1 – 7,7 – 10,3 – 12,9 – 15 – 17,6 – 20,2 – 22,8 - 25	Fejlgrænse
0 - 25 25 - 50 50 - 75 75 – 100 100 - 125	4 4 5 5 5	Anvendes mikrometerskruen til differensmåling? Ja ☐ nej ☐ Friktionsskrue OK? Ja ☐ nej ☐	Udvendig måling: Indvendig måling: Dybdemåling:
Skalainterval i µm		Max målelængde:	

Diagram over afvigelse

Målinger
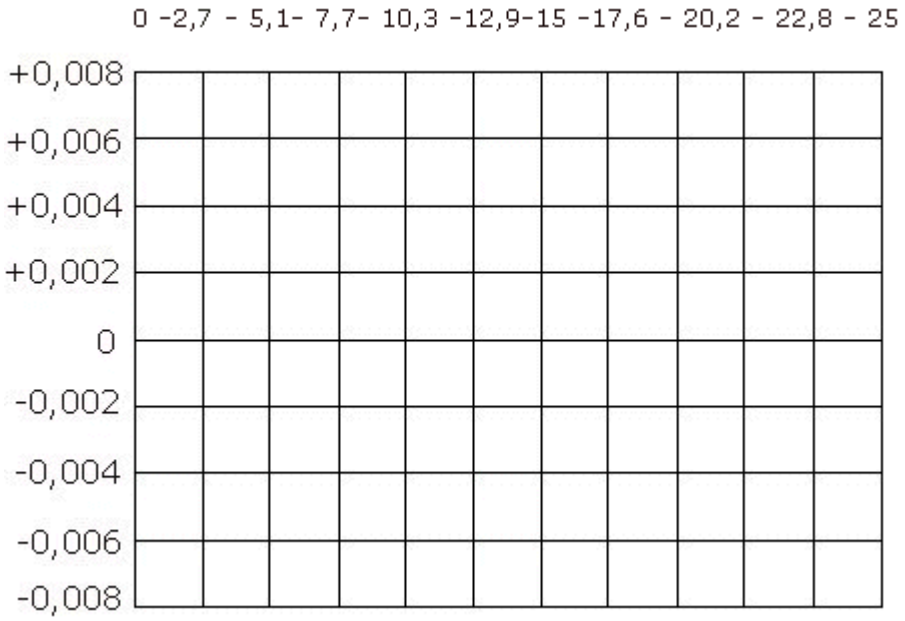
Noter kontrolmålene: