Skydelære kontrolkort

		Navn
Skive Tekniske Skole	**Kalibrering**	Skydelære ID. Nr. Kontrol Dato:

Stamdata for skydelære

Levarandør:	Fabrikat:	Anskaffelsespris:
Kalibreringsinterval:	Certifikat nr:	Dato.

Tolerance for skydelære

Målelængde i mm:	Kontrolmål i mm:	Tilladt afvigelse i visning µm: hvis nonius = 0,1 & 0,05	Tilladt afvigelse i visning µm: hvis skala = 0,02	Kan skydelæren nulstilles et vilkårligt sted?	Fejlgrænse:
0 100 200 300	0 - 12,9 - 22,8 - 41,4 - 55,1 - 67,6 - 75 - 90,3 - 107,7 - 120,2 - 142,5 - 150	50 60 70 80	20 30	Anvendes skydelæren til differensmåling? ja nej	Udv. måling: Indv. måling: Dybdemåling:
Skalainterval i µm		Max målelængde:			

Diagram over afvigelse Noter kontrolmålet/ne:

Udvendig måling

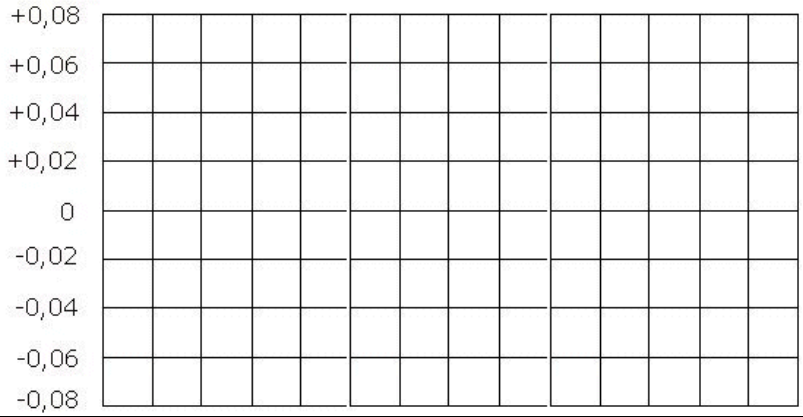

Indvendig måling

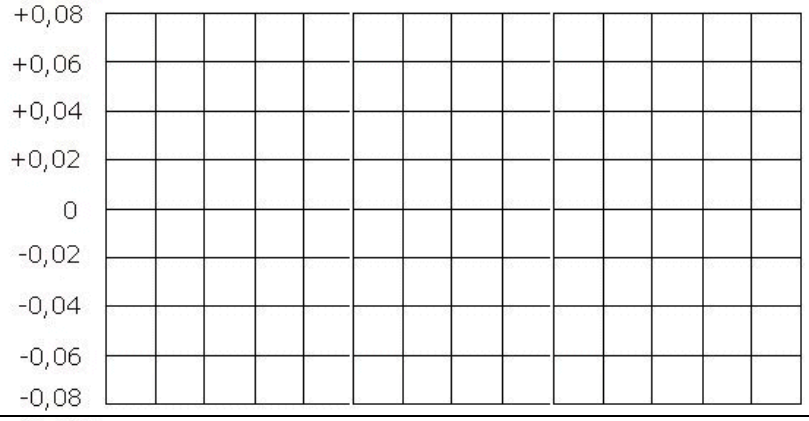
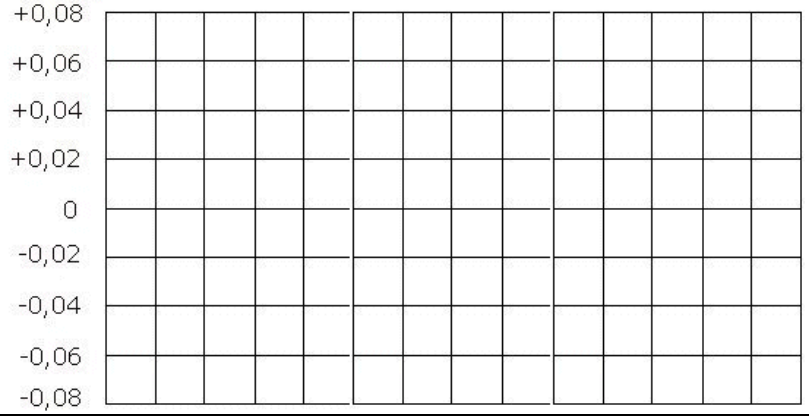
Dybde måling